




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

1. Ultrasound terapi me 4 kanale

Specifikime Teknike

- Ekran Touch Screen
- Me 4 kanale te pavarur
- Me 2 sonda
- 1 sonde me sipërfaqe deri ne 5.5 cm²
- 1 sonde me sipërfaqe deri ne 0.9 cm²
- Frekuenca 1 & 3 MHz
- Fuqia e vazhdueshme deri ne 2 W / cm²
- Fuqia pulsuese deri 4 W / cm²
- Deri 60 protokolle te memorizuara
- Te pakten deri 60 programe te lira ne memorie
- Te jete e pajisur me 8 lloje vale trajtimi
- Stadi i punes: 100- 240 V 50Hz
- Te jete me klasekonsumienergjie A ose B
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite






REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

**Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës**

2. Terapi me Infratekuqe

Specifikime Teknike

- Me kohe te percaktueshme 10 deri 60 minuta
- Fuqia dalese maksimale 250 W
- Llampe qeramike me ekran mbrojtës
- Lartesi e rregullueshme
- I mbajtur ne stativ qeramik me 5 rrota
- Krahu i tipit fleksibel
- Nxehtesia maksimale 90 grade, e arritshme per nje kohe nen 10 minuta.
- Te kete mbi 2 sete percmimi energjie
- Stadi I punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete me klase konsumi energjie A ose B
- Te jete I pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

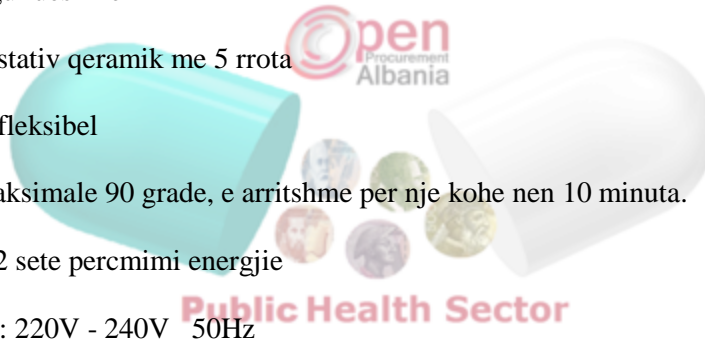



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

3. Terapi me lazer

Specifikime Teknike

- Me 2 sonda
- Te jene me me shume se 1 diode secila.
- Me dy kanale te vecanta
- Metoda trajtimi te vazhdueshme ose ne forme pulsante
- Ekran LCD
- Sonde me gjatesi vale nga 640nm deri 1050nm
- Frekuenca 200 Hz – 10kHz
- Te kete opsion karikimi me bateri dhe te jete portabel
- Te jete I pajisur me syze mbrojtese anti-lazer
- Te jete me klase konsumi energjie A ose B
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garancia jo me pak se 2vite





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

**Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës**

4. Terapi me vakum

Specifikime Teknike

- Me 2 kanale dalese
- 4 kupa vakumi me sfungjer me diameter jo me te vogel se Ø 50 mm
- 4 elektroda
- Fuqia thithese te jete te pakten Brenda rangut 0 – 0.5 bar
- Vakum dhe frekuence e ndryshueshme, e perzgjedhshme
- Qarku I vakumit I vetrregullueshem dhe me fikje automatike te pompes thithese
- Mundesi lidhje per trajtimet e kombinuara
- Stadi I punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete I pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

5. Magneto Terapi

Specifikime Teknike

- Te jete I pajisur me minimum 40 programe presete
- Minimum 10 programet te jene te dedikuar per frekuencat nga 1Hz deri ne 100Hz
- Te kete minimum memorie per 5 programete lira per perdoruesin
- Te jete me dy kanale
- Te kete fuqi deri ne 200 Gauss per cdo kanal
- Stadi I punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete I pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vit



Public Health Sector




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

6. ElektroTerapi

Specifikime Teknike

- Te kete ekran me Touch Screen
- Te jete me 2 kanale dalese
- Minimum 110 protokolle ne memorie
- Te jete I pajisur me Smart Card
- Te gjeneroje forme vale per frekuenca te uleta dhe te mesme
- Te krijoje kurben I/T
- Te kete 4 elektroda me siperfaqe min 50x50mm
- Te gjitha elektrodas te jene te pajisura me sfungjere
- Stadi I punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete I pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

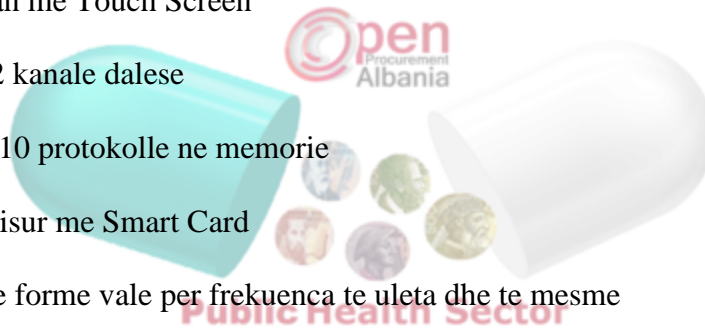



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

**Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës**

7. TENS

Specifikime Teknike

- Te kete 4 kanale te pavarur
- Me kohe te percaktueshme nga 10 deri ne 60 minuta
- Te gjeneroje vale kuadratike bifazike
- Te gjeneroje vale kuadratike monofazike
- Max 230mA dhe ngarkese max 500 Om
- Te jete I pajisur me 4 bateri AA te karikueshme
- Te jete I pajisur me 4 fisha me splitter per 8 elektroda secilin
- Me gjeresi impulse 50-300 MS e rregullueshme
- Impulse me frekuence 2-150HZ e rregullueshme
- Zgjatja e impulsit 1-8 sek
- Me kohe tkurrje 2-90 sek
- Te jete I pajisur me minimum 3 programe TENS dhe minimum 5 EMS
- Te perfshihet karikuesi I baterise
- Stadi I punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete me klase konsumi energjie A ose B
- Te jete I pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se dy vite



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

8. Aparat per terheqje lumbare dhe cervikale

Specifikime Teknike

- Te jete I pajisur me shtrat per 2 metoda: Lumbar traction dhe Cervical traction
- Shtrati duhet te jete I pajisur me pjese te rreshqitshme per terheqjen Lumbare
- Seksioni lumbar te jete me kend te rregullueshem deri ne 10°
- Aparatura duhet te jete e pajisur me:
 - Shirit torakal mesatar
 - Shirit torakal te madh
 - Shirit pelvic mesatar
 - Shirit pelvic te madh
 - Shirit per mjekren
 - Jastek cervikal
 - Jastek lumbar
- Stadi I punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete I pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

9. Aparat per ionophoresis

Specifikime Teknike

- Me 2 kanale
- Te jete e pajisur me butona per rregullimin e kohes
- Te jete e pajisur me rregullatorrryme per cdokanal ne menyretepavarur
- Te kete 2 elektroda me silicon konduktiv me siperfaqe min 45mm x 45mm dhe 60mm x100mm
- Te kete 2 mbeshtjellese sfungjeri me siperfaqe min 45mm x 45mm dhe 60mm x100mm
- Stadi I punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete I pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

10. Aparat per Short Wave (Diathermy)

Specifikime Teknike

- Aparati te jete I pajisur me ekran touch
- Te permbaje te pakten 90 protokolle klinike
- Te kete minimumi 200 programe memorie per perdoruesin
- Frekuenca e punes te jete mbi 25MHz
- Frekuenca pulsuese te jete jo me e vogel se 10-800 Hz
- Kohezgjatja e pulsit te jete te pakten 20 – 400µsec
- Koha e trajtimit te jete te pakten 1-60minuta
- Te kete dy kanale dalese
- Te jete e pajisur me dozimetri termale
- Te jete I pajisur me tekniken me fushe induksioni dhe dielektrike
- Energjia e daljes te jete pulsuese dhe e vazhdueshme
- Te jete I pajisur me indikator per te sinjalizuar mbi dozimin
- Te kete krahe fleksibel per lehtësi ne montimin e elektrodave
- Te jete me klase konsumi energjie A ose B
- Te perfshije aksesoret:
 - Te gjithë kabllo të nevojshëm
 - Set Elektrodash me diametër afersisht 8 dhe 16 cm
 - Kapacitor me sipërfaqe të pakten 200cm²
 - Pllaka dopio per metoden me fushe
 - 2 Krahe fleksibel per elektrodat
- Stadi I punes: 100 V – 240V 50- 60 Hz
- Te jete I pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2vite

Public Health Sector



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

11. Aparat per Presoterapi

Specifikime Teknike

- Te kete jo me pak se 8 sektore te pavarur
- Te jete me ekran
- Fuqia e shtypjes te jete e kontrollueshme dhe e pavarur per cdo sektor
- Koha e ciklit te jete e rregullueshme nga 20 deri ne 240 sek
- Te kete menyre te dyfishte veprimi me gradient ose presion
- Presion i rregullueshem nga 20-120 mmHg
- Te jete i pajisur me vakum automatik i cili heq ajrin nga veshja
- Te ofroje 2 menyra sub-terapie (Uncorking dhe Focus)
- Menyra e presionit/ gradientit te jete e vazhdueshme ose me nderprerje
- Te jete me klase konsumi energjie A ose B
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

12. Aparat per Parafinoterapi

Specifikime Teknike

- Stadi i punës 220 – 240 VAC, 50/60Hz
- Kapaciteti variabel nga 5 -20 kg
- Te jete i pajisur me mates kohor te sterilizimit
- Te kete mekanizma per heqjen lehtesisht te parafines
- Te jete e cmontueshme nga mekanizmi mbajtes
- Konsumi maksimal jo me shume se 250W
- Te jete me klase konsumi energjie A ose B
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

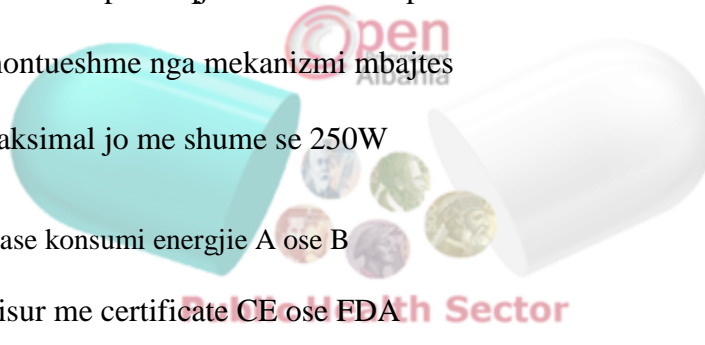



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

13. Shtrat me levizje hidraulike

Specifikime Teknike

- Kapaciteti mbajtes te jete deri ne jo me pak se 185 kg
- Me lartesi te rregullueshme elektrike dhe hidraulike
- Lartesia minimale dhe maksimale te jete te pakten brenda rangut 50-90cm
- Stadi i punes: 220 – 240V 50Hz
- Shtytja e motorit te pakten 5500 N
- Mbeshtetesja e kokes te jete e rregullueshme
- Mbeshtetesja e kokes te kete kend rrotullimi te pakten brenda rangut +60° -10°
- Te kete sistem frenimi qendror
- Gjeresia e shtratit jo me pak se 75 cm
- Veshja te jete e posatshme per perdorim spitalor, me agjente antibakterial
- Te jete i pajisur me certificate CE
- Garanci jo me pak se 2 vite




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

14. Stola rrotullues

Specifikime Teknike

- Me 5 rrota
- Me mbeshtetese te kurrizit
- Me gjatesi te rregullueshme nga piston hidraulik
- Mbulesa prej lekure per perdorim spitalor
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

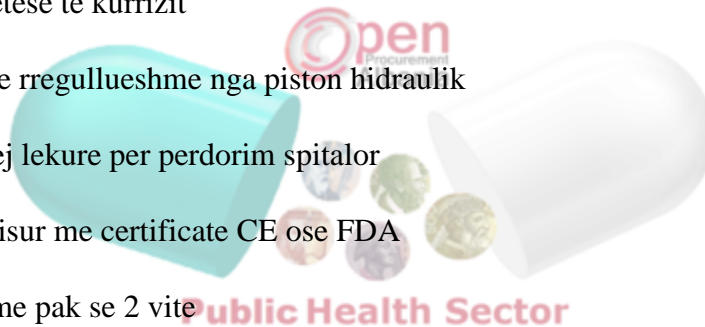




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

15. Tavoline me rrota per pajisjet

Specifikime Teknike

- Te jete e perbere nga material i pandryshkshem
- Te jete me rrota
- Te jete me dy kate
- Te kete varesë për sistemimin e fishave dhe kabujve të aparaturave
- Te jete afersisht 90cm e larte
- Siperfaqja e mbajteseve te jete te pakten 55 x 40 cm
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

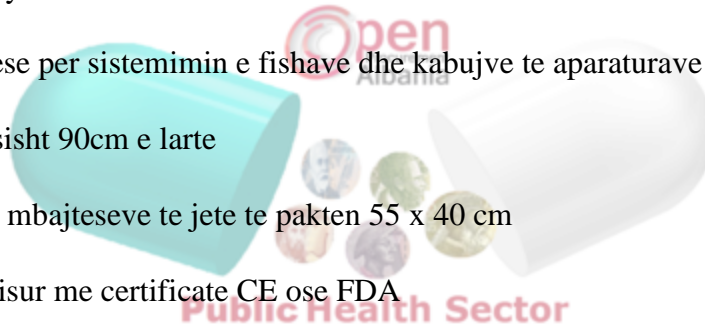



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

16. Cikrik per ushtrimet e shpatulles

Specifikime Teknike

- Te ofroje mundesine per kryerjen e ushtrimeve si ne kembe edhe ulur
- Te kete set me pesha per kryerjen e ushtrimeve me pasha te ndryshme
- Te kete gjatesi jo me te vogel se 200cm
- Te kete lartesi te rregullueshme te pulexhes
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

17. Set me topa mjekesor

Specifikime Teknike

- Seti duhet të përmbajë topa me diameter të ndryshëm
- Seti duhet të përmbajë topa me pesha të ndryshme 0.5 – 5 kg
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

18. Shoulder wheel

(Pajisje per levizje pasive te supit)

Specifikime Teknike

- Te kete skelet metalik
- Lartesia e rrotes te jete e ndryshueshme per ti'u pershtatur trupit te perdoruesit
- Te ofroje mundesine e te ushtruarit ulur ose ne kembe
- Aparati duhet te kete opsionin e shpejtesise se rregulleshme
- Rangu i levizjeve te jete i rregulleshem elektromekanikisht
- Stadi i punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete e pajisur me bateri
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

19. Aparat ushtrues per krahun

Specifikime Teknike

- Aparati duhet te kete opsionin e shpejtesise se rregulleshme
- Rangu i shpejtesise duhet te varroje nga minimum 2°/sek deri te pakten 4°/sek
- Stadi i punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete e pajisur me bateri
- Te kete suport mbeshtetes per berrylin dhe parakrahun
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

20. Krah ngrites/levizes per pacient

Specifikime Teknike

- Kapaciteti mbajtes minimum 170kg
- Te jete me nivel shpejtesie te rregullueshem
- Te kete krah me lartesi te rregullueshme
- Stadi i punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite






REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

21. Shkalle Suedeze

Specifikime Teknike

- Skeleti anesor te jete i perforcuar me celik
- Materiali i shufrave horizontale te jete prej druri
- Dimensioned te jene te pakten 80 x 230 cm
- Kapaciteti mbajtes te pakten 115 kg
- Te jete e montueshme ne mur
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite






REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

22. Biciklete Ergometrike

Specifikime Teknike

- Te jete me timon te levizshem, te manovrueshem
- Te jete me shale te levizshme
- Te kete programe te ndryshme per te analizuar punimin ne ngarkese
- Te kete kapacitet mbajtes jo me pak se 140 kg
- Te kete ekran Touch Screen
- Te kete hapësire ne memorie per programe shtese
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

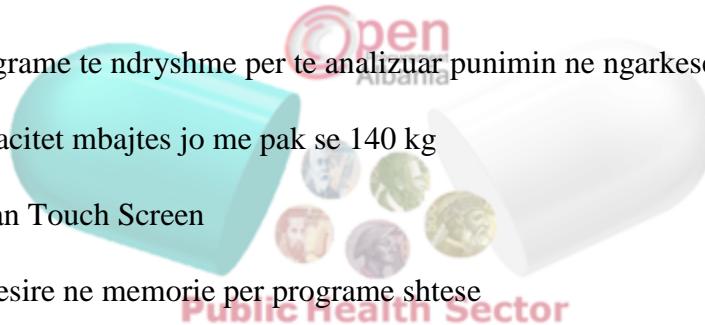



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

23. Shtrat Ortostatik

Specifikime Teknike

- Ngarkesa maksimale të arrije të pakten 110 kg
- Pjerresia të jete e rregulleshme
- Lartësia nga dyshemeja të jete të pakten 80 cm
- Gjatesia duhet të jete të pakten 185 cm
- Veshja të jete prej materiali antibakterial për përdorim spitalor
- Të jete i pajisur me sistem frenimi individual në çdo rrotë
- Të jete i pajisur me rrip të gjerë mesazhi për mbështetje të sigurt të pacientit me shtratin
- Të jete i pajisur me bateri të karikueshme
- Të përfshihet karikuesi i baterive
- Të jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo më pak se 2 vite

24. Shtrat terapeutik pozicionues




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

**Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës**

Specifikime Teknike

- Te jete me 3 seksione te levizshme individuale
- Kapaciteti mbajtes te pakten 130 kg
- Kendi vertikal te jete deri ne 90°
- Te jete me bateri te karikueshme
- Karikuesi i baterise te jete i perfshire
- Rrotatat te jene me diameter te madh, te pakten 110 mm
- Te kete mbeshtetese per shputat e kembes
- Shputat e kembeve te jene me kend te rregullueshem
- Veshja te jete prej materiali antibakterial per perdorim spitalor
- Te jete i pajisur me bateri te karikueshme
- Te perfshihet karikuesi i baterive
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

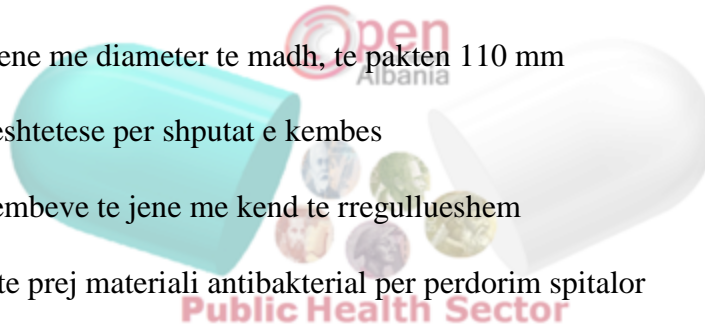




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

25. Paterica

Specifikime Teknike

- Te jene me material alumini
- Me 4 kembe te parreshqitshme
- Te jete portative
- Lartesia e kembeve te jete e rregullueshme
- Kapacitet mbajtes te pakten 90 kg
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

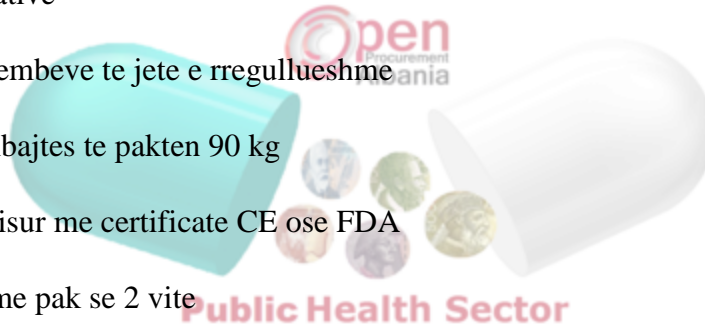



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

26. Paralele

Specifikime Teknike

- Paralelet te jene te pakten 220 cm te gjata
- Me skelet celiku
- Dorezat te jene te parreshqitshme
- Lartesia e paraleleve te jete e rregullueshme
- Kapaciteti i nje paraleli individual te jete jo me pak se 120 kg
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite



Public Health Sector



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

27. Makineri rrotulluese per kycin e dores

Specifikime Teknike

- Diapazoni Shtirirje -Perkulje: $80^{\circ} \div 0^{\circ} \div 80^{\circ}$
- Diapazoni i devijimit Ulnar-Radial: $20^{\circ} \div 0^{\circ} \div 30^{\circ}$
- Te kete shpjetesesi te rregullueshme
- Rangu i shpejtesise duhet te varroje nga minimum $2^{\circ}/\text{sek}$ deri te pakten $4^{\circ}/\text{sek}$
- Stadi i punes: 220V - 240V 50Hz
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

28. Tabele proprioceptive

Specifikime Teknike

- Te jete me mbulese lekure
- Diametri te pakten \varnothing 70 cm
- Lartesia te pakten 10 cm
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

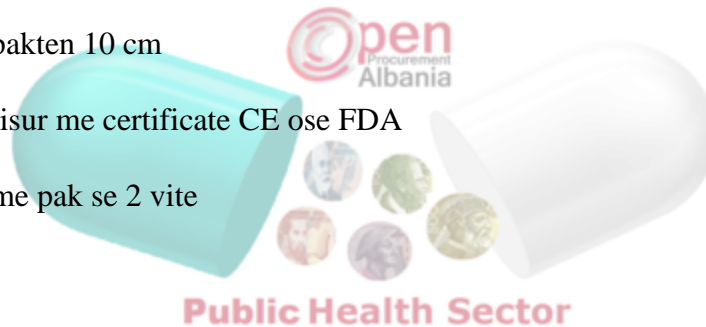



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

29. Jastek per pozicionim

Specifikime Teknike

- I mbushur me material sfungjer shkume
- Te jete i veshur me lekure
- Te jete rezistent ndaj flakeve
- Te mund te lahet dhe te kete jetegjatesi
- Veshja te jete e heqshme
- Gjatesia te pakten 40 cm
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite






REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

30. Pasqyre e vijeuar

Specifikime Teknike

- Permasat te jene te jo me pak se 2m x 2m
- Te jete e vijeuar me sistem katrorash
- Te jete me kornize per te eleminuar demtimet nga xhami
- Te jete e levizshme me rrota
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

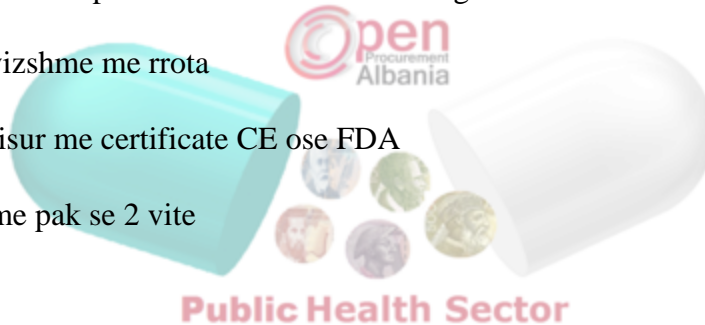




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

31. Topa terapeutik per duar

Specifikime Teknike

- Seti duhet te permbaje material me 5 nivele fortesie
- Te jene anti-bakterial
- Te jene jo toksik
- Te jene jo vajor
- Te jene pa arome
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite






REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

32. Piste vrapimi

Specifikime Teknike

- Te kete te integruar funksionet : WarmUp dhe Cool Down
- Te kete funksionin e pjerresise me te pakten 2 nivele
- Te kete opsionin e kontrollit manual
- Te kete te inkorporuar matesin e pulesit
- Te kete disa nivele kontrolli te shpejtesise
- Stadi i punes: 220V - 240V 50Hz
- Kapaciteti mbajtes te pakten 110 kg
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

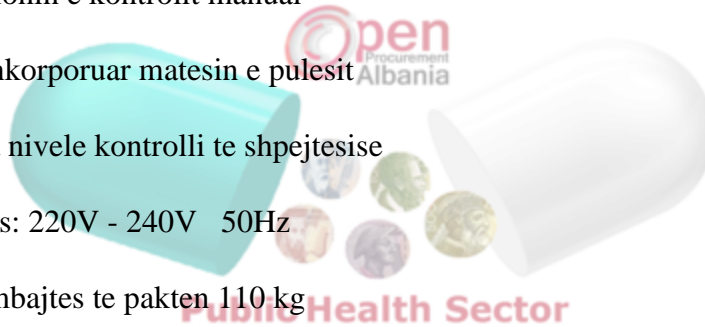



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

33. Pajisja per rrotullimin e kycit

Specifikime Teknike

- Diapazoni Shtrirje -Perkulje: $80^\circ \div 0^\circ \div 80^\circ$
- Diapazoni i devijimit Ulnar-Radial: $20^\circ \div 0^\circ \div 30^\circ$
- Te kete shpjetesesi te rregullueshme
- Rangu i shpejtesise duhet te varroje nga minimum $2^\circ/\text{sek}$ deri te pakten $4^\circ/\text{sek}$
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

34. Set me topaxheli

Specifikime Teknike

- Te jene set me topa me diameter nga 5 cm deri ne 20 cm
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite






REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

35. Set me pesha per kycet

Specifikime Teknike

- Seti te kete pesha nga te pakten 0.5 kg – 2.5 kg
- Te jete me veshje lekure
- Te kete rrip per mbeshtjellje
- Te jete i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

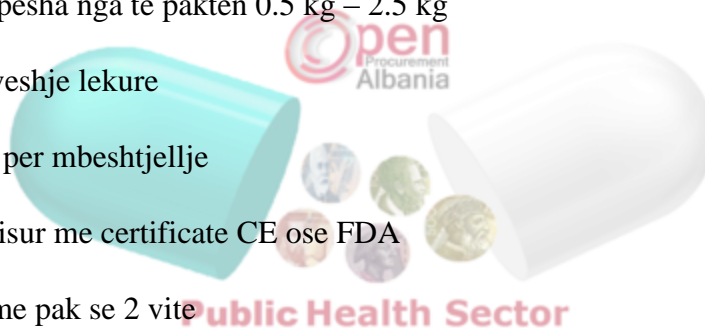




REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

36. Set gira

Specifikime Teknike

- Seti duhet të përmbajë gira me peshe nga 1 – 5 kg
- Të jenë me veshje gome
- Dorezat të jenë të dhembzuara për kapje sa më të pershtatshme
- Të jetë i pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo më pak se 2 vite






REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

37. Top Zvicerian Ortopedik

Specifikime Teknike

- Diametri i jete te pakten 80 cm
- Te kete kapacitet mbajtes te pakten 110 kg
- Te jete I pajisur me certificate CE ose FDA
- Garanci jo me pak se 2 vite

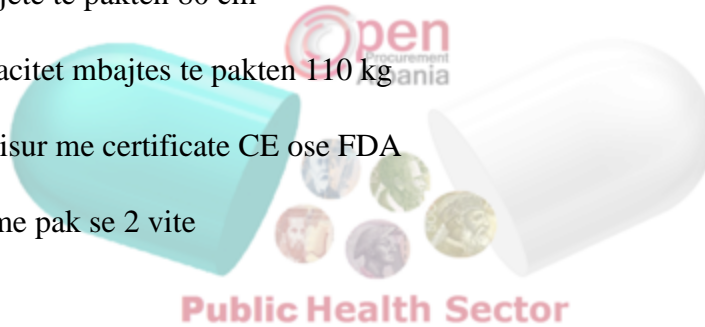



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

38. Karrige per bokset

Specifikime Teknike

Stol ekzaminimi mjeku I rumbullaket, pa mbeshtetese,

- ndenjesja me diameter jo me te vogel se 36 cm,
- e veshur me material rezistent antibakterial, kundrazjarrit dhe I pastrueshem, m
- e rregjistrues lartesisie nga 50-60cm, m
- e bazen plastike te perbere nga 5 kembe-rrota per te levizur



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË


Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

39. Shtrat Vizite

Specifikime Teknike

Shtrat vizitash me permasa jo me te vogla se 180 x 57x h 73 cm,

- pesha max 120 kg,
- me dy pjese: pjesa shpinore e cila ka mundesi te levize ne disa pozicione,
- e paisur me dyshek te veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe te lavashem, me permasa jo me te vogla se (50 x 61x h 5.5cm) dhe pjeses se fiksuar me permasa jo me te vogla se(130x64x h 5.5 cm),
- e kornizuar, e paisur me 4 kembe inoksi, e paisur ne fund te shtratit me mbajtesen e letres rulo universale.



Public Health Sector



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

40. Karrige per pritjen

Specifikime Teknike

- Set karrigesh vizituesh, I perbere nga 3 karrige; ku cdo grup perbehet nga 3 karrige te lidhura bashke dhe ndahet nga nje tavoline e vogel me permasat e ndenjeses.
- Ndenjeset te jane te veshura me material kundra zjarrit, antibakteriale, te padeptueshme nga uji dhe i lavashem,
- shpinoret perbehen me nje material me te forte (laminat)





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Lot 1. F.V pajisje mjekësore për kabinetin e fizioterapisë dhe rehabilitimit në Spitalin
Universitar të Traumës

41. Krevat Masazhi

Specifikime Teknike

- Krevat masazhi me permasa jo me te vogla se 180 x 57x h 73 cm, pesha max 120 kg, i pa ndare ne pjese,
- i paisur me dyshek te veshur me material rezistent kundra zjarrit, antibakterial dhe te lavashem, i kornizuar,
- i paisur me 4 kembe inoksi.
- Te kete nje vrime me permasat e fytyres per lejuar qendrimin horizontal gjate masazhit.

