

Shtojca 9

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Secifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Njesia	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total pa tvsh
1	Sistem Qendror monitorimi	kompjet	1		
2	Sistem Sinjalistike pacienti	Komplet	1		
3	Mates HB e glukozuar	cope	1		
4	hemoglobulinometer	cope	1		
5	Shiring elektrike	cope	3		
5	Oksimeter mjeku	cope	2		
Çmimi Neto)					1 525 000
TVSH (%)					
Çmimi Total					

MATES HEMOGLOBIN E GLUKOZUAR

Public Health Sector

- Aparature gjysme automatike per matjen e hemoglobines se glukozuar
- Te japi rezultatet Brenda minimumit 4 minutave
- Te perdoret me gjak direct ose te procesuar
- Me precision CV te pakten 3% per 7% a1cHCT
- Diapazoni I matjeve : 4-15 % A1c DCCT
- Te lidhet me kompjuterin me porte USB
- Vellimi I gjakut kapilar ose venoz 4 mikroliter


SHIRINGE ELEKTRIKE

- Shiringe elektrike per injeksion te vazhdueshem dhe mikro me ekran LCD
- Te njohi madhesine e shiringes automatikisht,
- Shkalla e rrezes së diapazonit të infuzionit është të paktën 0.1 deri në 1200 ml/orë me një rritje minimale prej jo më shumë se 0.1 ml/orë

- Volumi I infuzuar te jete nga 0.1-9999 ml
- Sistemi I sigurise KVO me 0.1ml/ore
- Vetetestim te sistemit,
- 8 Nivele per okluzionin
- Alarme per lajmerim te keqfunksionimit,
- Saktësia e shkallës së infuzionit nuk është më e madhe sesa +/-2%
- me llogaritje automatike te dozimit ne baze te peshes, gjatesise etc,
- me porte rs232 per alarm te infermieres
- Me bateri te zgjasi minimum 4 ore

OKSIMETER

- Per matjen ne kohe reale dhe me saktesi te SpO2% and Pulse Rate
- Me ekran LCD me grafike ne 4 pamje te ndryshme
- Ruan te dhenat e pacientit per 72hrs
- I pajisur me karte SD per upgrate dhe ruajtje te dhenash
- I afte te dedektoje dhe te kryeje analizen APG
- Kohezgjatja e baterise: 12 hrs (Li – ion)
- I afte te kaloje the dhenat per print dhe analize ne PC Kompjuter

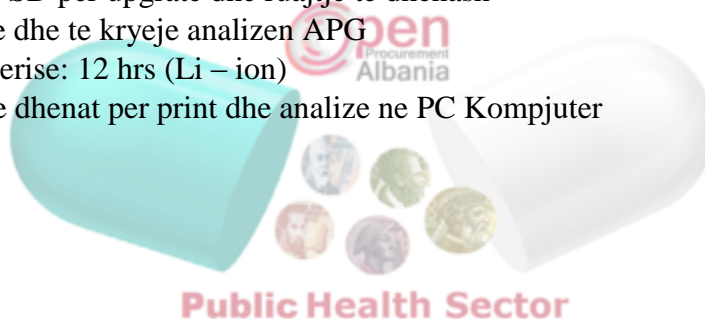

HEMOGLOBINMETER

Mates I kombinuar I hemoglobines dhe hematokritit point of care

Me ekran lcd per lezim te qarte te rezultateve

I afte te kryeje analizen Brenda maksimumi 30 sekonda

I pajisur me teknologjine me ultratinguj

Te perdoret me gjak direct ose te procesuar

Me precision te pakten 0.4% HCT

Lineariteti :10.5-70% hct

Te lidhet me kompjuterin me porte USB

Vellimi I gjakut kapilar ose venoz 40 mikroliter

SISTEM QENDROR MONITORIMI

- **SISTEM QENDROR MONITORIMI KOMPATIBEL ME MONITORET E PACIENTIT VOTEM VP1000.**
- I afte te pasqyroje te dhenat e te pakten 250 pacienteve njekoheisht,
- I afte te ruaje te dhenat e te pakten 30 diteve
- Me orientim bi –direksional per convenience te mjekut
- Te lidhet me minimumi 16 shtreter njekoheisht
- Me pasqyrimin e funksioneve standard te ECG, SpO2, NIBP, Resp, 2 Temp, 2 IBP, :
- E pajisur me SD Card(Max 8 Gbyte)
- Te komunikojte me LAN and Wireless LAN
- I pajisur me te gjitha alarmed per monitored e vecante
- I afte te perpunoje te dhenat per paciente te ndryshem

SISTEM SINJALIZIM PACIENTI

Public Health Sector

- Sistem sinjalizimi pacienti per raste emergjence.
- I lidhur direct me dhomen e monitorimit te mjekeve ose stafit perkates
- Kontaktor elektrik I dedikuar per secilin pacient
- I pajisur me Alarm zanor dhe visual per nje alertim te stafit mjekesor

PRODUKTET TE KENE CERTIFIKATAT ISO dhe DEKLARATE KONFORMITETI /CE

AFATI I LEVRIMIT 10 DITE PREJ NENSHKRIMIT TE KONTRATES

MOSTRA PER ARTIKUJT: 1, 2,3,5

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Afatet e lëvrimit: 10 dite nga nenshkrimi I kontrates.

1	2	3	4	5	6
Nr	Përshkrimi i mallrave	Njesia	Sasia	Çmimi Njësi	Çmimi Total pa tvsh
1	Sistem Qendror monitorimi	kompjet	1		
2	Sistem Sinjalistike pacienti	Komplet	1		
3	Mates HB e glukozuar	cope	1		
4	hemoglobulinometer	cope	1		
5	Shiring elektrike	cope	3		
5	Oksimeter mjeku	cope	2		
Çmimi Neto)					1 525 000
TVSH (%)					
Çmimi Total					