

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

-Materialet e mjekimit duhet të përmbushin standartet CE ose CE sipas direktivës MDD 93/42 EEC. Ato duhet të jenë të markuara CE në momentin e lëvrimin të mallit.


Afati i skadences: jo më të vogël se 12 muaj nga data e lëvrimin të mallit në destinacion.

Skadencia duhet të jetë e shënuar në ambalazh.

Ambalazhimi të jetë i përshtatshëm sipas llojit të mallit të shoqëruar me etiketat dhe markimin përkatës.

Ofertuesi duhet të përmbushë specifikimet teknike të materialeve mjekësore detyrimisht sipas përcaktimit të bërë në përshkrimin e mallrave në DS të kësaj procedure prokurimi.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

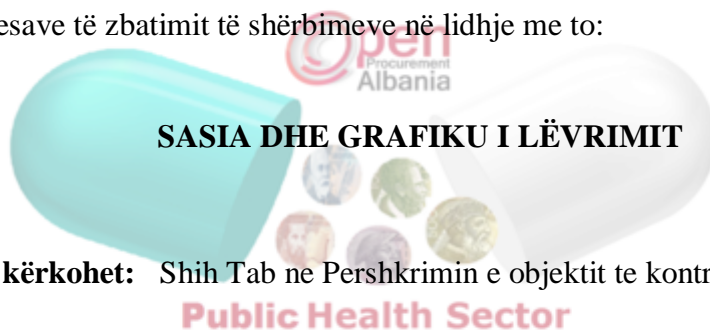

Sasia e mallit që kërkohet: Shih Tab në Përshkrimin e objektit të kontratës

Afatet e lëvrimin:

50% e mallit të sillet brenda 7 diteve nga firmosja e kontratës.

50% brenda 14 diteve në vijim.

Kolaudimi i mallrave do të bëhet në Farmacine e SRD, si dhe magazinimi.

Shpenzimet e transportit janë përfshirë në cmim.

Kontrata fillon efektet menjëherë me nënshkrimin e saj me afat përfundimtar në 15 Prill 2017.